


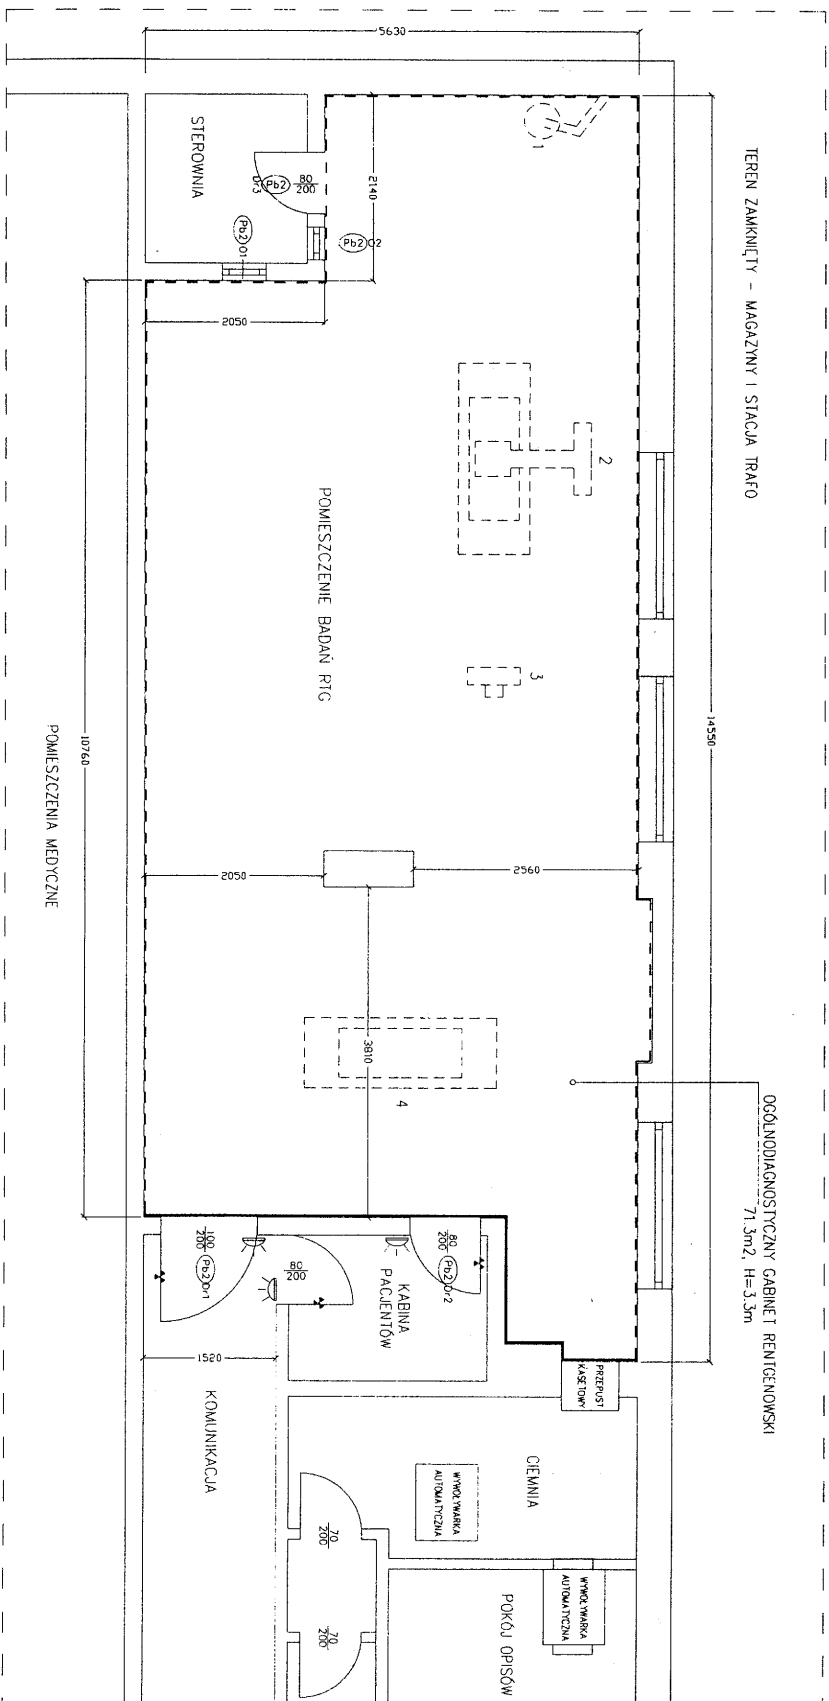

OZNACZENIA:

- 1 - APARAT RTG STOMATOLOGICZNY DO ZDJĘĆ PUNKTOWYCH IRIX 70 FIRMY TROPHY
- 2 - APARAT RTG SIRESKOP CX-51 FIRMY SIEMENS (stół do zdjęć kośćnych z kolumną podlogową BD-CX)
- 3 - APARAT RTG SIRESKOP CX-51 FIRMY SIEMENS (stojak do zdjęć odległościowych)
- 4 - ZESTAW RTG SIRESKOP TYP CX-51 FIRMY SIEMENS (stół do zdjęć odległościowych)
- 5 - ZNAK OSTRZEGAWCZY NA DRZWIACH W/G ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DN.21.08.2006
- 6 - LAMPY SYGNALIZACYJNE NAD DRZWIAMI
- 7 - TYNK BARTOWY GRUBOŚCI 2cm
- 8 - BLACHA OKROWIANA GRUBOŚCI 2.0mm
- 9 - DRZWI RTG O OCHRONNOŚCI 2.0mm Pb
- 10 - OKNO RTG O OCHRONNOŚCI 2.0mm Pb

ZAFACZNIK NR 3 DO SIWZ

SPZZOZ Przysucha Al. Jana Pawła II 9A 26-400 Przysucha	ROZBUDOWA ZDO (TK, RTG)
STAN ISTNIEJĄCY	2012.05.23